

Vision Sperm® Integro

Интегрированное решение для анализа спермы

АНАЛИЗ СПЕРМЫ

Категория	Платный анализ
ИН анализа	365
Количество анализов	1
ИН пациента	10
ФИО	Сидоров Иван Петрович
Дата рождения	28.05.1975
Пол	Муж.
Адрес	ул. Амутсона, 25-10
Полис	Макс М Полис № 8767457855212
Медицинская карта	56434

Анализ спермы

Параметры	Результат
Продолжительность воздержания	5
Время между эякуляцией и анализом	30
Внешний вид	Нормальный
Разжижение	Нормальное
Консистенция	Нормальная
Вязкость	Нормальная
Объем	5
pH	8
Подвижность сперматозоидов (%)	
(a) с быстрым поступательным движением	70
(b) с медленным поступательным движением	15
(c) малоподвижные	10
(d) неподвижные	5
Подвижность сперматозоидов (М/мл)	
(a) с быстрым поступательным движением	18



Vision Sperm® Integro

Исследование качества спермы и микроскопия спермы в одной системе

Единая система для анализа качества спермы, работы с микроскопическими препаратами, данными пациента и результатами анализа

1 База данных пациентов

Все данные пациентов представлены в виде таблиц, которые можно настроить самостоятельно.

2 Цифровой препарат


Цифровой препарат — лучший способ оценить морфологию сперматозоидов. Оставляйте свои комментарии прямо на изображении.

Анализ качества спермы

Используйте автоматический анализатор качества спермы для скрининга. Внесите полученные параметры в ПК и интегрируйте в общий отчет спермограммы.



Атлас объектов

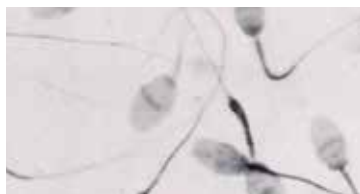

Развивайте свои профессиональные знания путем создания и ведения атласа. Добавляйте необходимые разделы и текстовые комментарии к изображениям.

Повышение квалификации




При работе с системой Vision Sperm®, специалисты и лаборанты повышают свой опыт и квалификацию каждый день благодаря ведению атласа, просмотру изображений и комментариев в динамике.

Удаленный доступ



Обмен данными с ЛИС/ГИС. Хранение изображений и отчетов в базе данных позволяет организовать единую информационную среду для лечебного учреждения.

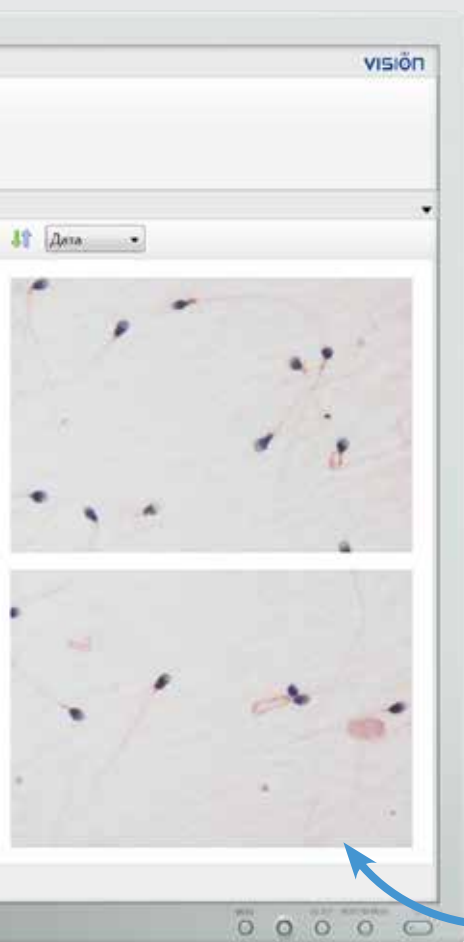

Микроскопия спермы

Изображения спермы добавляются к результатам анализа и формируют финальную картину анализа.



Отчет

Вы сами принимаете решение о том, каким будет ваш отчет. Вы можете учесть в бланке требования по форме и содержанию.

Vision Sperm® Integro

Рабочая станция
анализа спермы для
небольших и средних
лабораторий

Vision Sperm® Integro

Исследование качества спермы и микроскопия спермы

- Система микроскопии спермы Vision Sperm® Basic
- Анализатор спермы MES (по выбору)



Совместимость со всеми анализаторами качества спермы MES



SQA-V™



QwikCheck™ Gold



SQA IIC-P

Информация для заказа

Система Vision Sperm® Integro

Комплект включает: система микроскопии осадка мочи Vision Sperm® Basic,
анализатор качества спермы MES (по выбору)

По запросу

По вопросам приобретения, обращайтесь в представительство компании или к вашему региональному дистрибьютеру



VISION

www.vision-sperm.com
www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Шереметьевская, 85, стр. 2,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.com

WM WEST
MEDICA

www.westmedica.com